

病患詳細資訊

姓名：	Demo Patient	電話：	0123456789
病患ID：	1234	電子郵件：	Demo.Patient@example.com
出生日期：	01 一月 1960	性別：	女性

醫師：	John Brown	電話：	0123456789
-----	------------	-----	------------

平均 AHI:	平均使用 (小時/分鐘):	順從性*:	* 過去 30 天
6.2	8:23	97 %	自 25 十二月 2019 起使用 CPAP ≥ 4 小時的夜晚百分比

病患裝置

截至 23/01/2020

裝置：	SleepStyle Auto	濕度：	7.0
序號：	000000000	吐氣降壓：	3 cmH ₂ O
模式：	Auto	SensAwake:	開啟
最小設定壓力：	10.0 cmH ₂ O	SensAwake壓力：	7.0 cmH ₂ O
最大設定壓力：	14.0 cmH ₂ O		



順從性

	30天時間 25 十二月 2019 - 23 一月 2020	從設定日期開始 14 四月 2018 - 23 一月 2020
總天數：		
使用：	30 (100 %)	643 (99 %)
使用 >=4 小時：	29 (97 %)	642 (99 %)
未使用：	0 (0 %)	7 (1 %)
平均使用 (治療的天數)：	8:23	8:19
平均使用 (所有天數)：	8:23	8:13
運行總時間：	257:06	5400:24

效能**

AHI:	6.2	呼吸中止時間長 度：	15 s	CAI:	0.7
壓力：	7 cmH ₂ O	90%的壓力：	9 cmH ₂ O	在最大壓力：	2 %
系統漏氣：	47 升/分鐘	90%的漏氣：	61 升/分鐘	過度漏氣的時間：	33 %
SensAwake 偵測數目：	23 每晚	開啟 SensAwake 的時間：	100 %		

環境


環境溫度： 21 °C

使用

小時

平均: 8:23
使用天數: 100 %

■ 運行總時間
■ 使用總計
■ 使用 <4 h
..... 濕度



病患詳細資訊


姓名：	Demo Patient	電話：	0123456789
病患ID：	1234	電子郵件：	Demo.Patient@example.com
出生日期：	01 一月 1960	性別：	女性

AHI

每小時事件數

AHI: 6.2
 CAI: 0.7
 OAI: 1.9
 HI: 3.6

■ 總 AHI
 AHI = 5




壓力

cmH₂O

平均: 7.0
 百分之 90: 9.0

■ 平均
 ■ 百分之 90
 — 達到的最大壓力
 最小 / 最大




系統漏氣

升/分鐘

平均: 4
 百分之 90: 6

■ 平均
 ■ 百分之 90
 ■ 大量漏氣




使用

小時

平均: 8:23
 使用天數: 100 %


■ 運行總時間
 ■ 使用總計
 ■ 使用 <4 h
 濕度

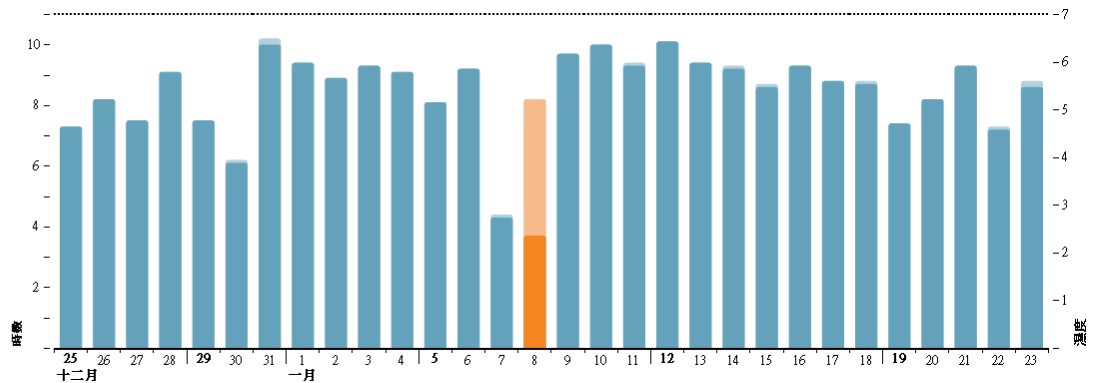

順從性摘要

姓名： Demo Patient 電話： 0123456789
 病患ID： 1234 電子郵件： Demo.Patient@example.com
 出生日期： 01 一月 1960 性別： 女性

處方歷史記錄




17 一月 2020
星期五 2:31 下午 - 11:23 下午

姓名: Demo Patient 電話: 0123456789
病患ID: 1234 電子郵件: Demo.Patient@example.com
出生日期: 01 一月 1960 性別: 女性


運轉時間

運行總時間: 8:48
使用百分比: 100 %




事件

AHI: 10.1
阻塞型呼吸中止: 19
OAI: 2.2
淺呼吸: 59
HI: 6.7
中樞型呼吸中止: 11
CAI: 1.3
流量限制: 0
流量限制/小時: 0.0
SensAwake 總計: 36
清醒降壓/小時: 4.1




壓力

cmH₂O
中位數: 7.0
百分之 90: 11.
緩慢升壓期
最小 / 最大



系統漏氣

升/分鐘
中位數: 4
百分之 90: 6
過度漏氣的時間: 21



處於壓力狀態的時間和事件


壓力 (cmH ₂ O)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
時間 (分鐘)	0	0	0	336	2	4	120	44	16	6	0	0	0	0	0	0	0
OA	0	0	0	3	0	0	7	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0
H	0	0	0	17	2	3	17	10	7	3	0	0	0	0	0	0	0
CA	0	0	0	3	0	0	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

18 一月 2020
星期六 2:00 下午 - 10:48 下午

姓名: Demo Patient 電話: 0123456789
病患ID: 1234 電子郵件: Demo.Patient@example.com
出生日期: 01 一月 1960 性別: 女性


運轉時間

運行總時間: 8:48
使用百分比: 99




事件

AHI: 6.7
阻塞型呼吸中止: 8
OAI: 0.9
淺呼吸: 44
HI: 5.0
中樞型呼吸中止: 7
CAI: 0.8
流量限制: 1
流量限制/小時: 0.1
SensAwake 總計: 32
清醒降壓/小時: 3.7




壓力

cmH₂O
中位數: 7.0
百分之 90: 10
緩慢升壓期
最小 / 最大



系統漏氣

升/分鐘
中位數: 5
百分之 90: 7
過度漏氣的時間: 54



處於壓力狀態的時間和事件


壓力 (cmH ₂ O)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
時間 (分鐘)	0	0	0	408	8	4	66	40	2	0	0	0	0	0	0	0	0
OA	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	0	0	0	15	2	2	15	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0
CA	0	0	0	4	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FL	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19 一月 2020
星期日 3:09 下午 - 10:33 下午

姓名: Demo Patient 電話: 0123456789
病患ID: 1234 電子郵件: Demo.Patient@example.com
出生日期: 01 一月 1960 性別: 女性


運轉時間

運行總時間: 7:24
使用百分比: 100 %




事件

AHI: 13.4
阻塞型呼吸中止: 38
OAI: 5.1
淺呼吸: 53
HI: 7.1
中樞型呼吸中止: 9
CAI: 1.2
流量限制: 18
流量限制/小時: 2.4
SensAwake 總計: 32
清醒降壓/小時: 4.3




壓力

cmH₂O
中位數: 7.0
百分之 90: 14
緩慢升壓期
最小/最大



系統漏氣

升/分鐘
中位數: 4
百分之 90: 6
過度漏氣的時間: 28



處於壓力狀態的時間和事件

壓力 (cmH ₂ O)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
時間 (分鐘)	0	0	0	310	4	6	22	20	26	8	48	0	0	0	0	0	0
OA	0	0	0	3	0	1	0	7	0	1	26	0	0	0	0	0	0
H	0	0	0	14	0	0	11	6	12	2	8	0	0	0	0	0	0
CA	0	0	0	3	0	1	2	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
FL	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	13	0	0	0	0	0	0


20 一月 2020
星期一 2:19 下午 - 10:36 下午

姓名: Demo Patient
病患ID: 1234
出生日期: 01 一月 1960

電話: 0123456789
電子郵件: Demo.Patient@example.com
性別: 女性


運轉時間

運行總時間: 8:12
使用百分比: 100 %



事件


AHI: 10.3
阻塞型呼吸中止: 23
OAI: 2.8
淺呼吸: 58
HI: 7.0
中樞型呼吸中止: 4
CAI: 0.4
流量限制: 3
流量限制/小時: 0.4
SensAwake 總計: 25
清醒降壓/小時: 3.0



壓力

cmH₂O


中位數: 7.0
百分之 90: 10.0
緩慢升壓期
最小/最大



系統漏氣

升/分鐘

中位數: 4
百分之 90: 5
過度漏氣的時間: 19



處於壓力狀態的時間和事件


壓力 (cmH ₂ O)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
時間 (分鐘)	0	0	0	364	8	26	56	22	4	4	8	0	0	0	0	0	0
OA	0	0	0	3	2	2	3	0	4	2	6	0	0	0	0	0	0
H	0	0	0	18	1	2	27	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0
CA	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FL	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0

21 一月 2020
星期二 12:27 下午 - 10:23 下午

姓名: Demo Patient 電話: 0123456789
病患ID: 1234 電子郵件: Demo.Patient@example.com
出生日期: 01 一月 1960 性別: 女性


運轉時間

運行總時間: 9:18
使用百分比: 100 %




事件

AHI: 4.1
阻塞型呼吸中止: 10
OAI: 1.1
淺呼吸: 25
HI: 2.7
中樞型呼吸中止: 3
CAI: 0.3
流量限制: 1
流量限制/小時: 0.1
SensAwake 總計: 23
清醒降壓/小時: 2.5




壓力

cmH₂O
中位數: 7.0
百分之 90: 7.0
緩慢升壓期
最小 / 最大



系統漏氣

升/分鐘
中位數: 4
百分之 90: 5
過度漏氣的時間: 24



處於壓力狀態的時間和事件


壓力 (cmH ₂ O)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
時間 (分鐘)	0	0	0	514	2	20	18	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
OA	0	0	0	6	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H	0	0	0	9	2	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CA	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
FL	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 一月 2020
星期三 2:08 下午 - 9:32 下午

姓名: Demo Patient 電話: 0123456789
病患ID: 1234 電子郵件: Demo.Patient@example.com
出生日期: 01 一月 1960 性別: 女性


運轉時間

運行總時間: 7:18
使用百分比: 99



事件


AHI: 5.7
阻塞型呼吸中止: 7
OAI: 1.0
淺呼吸: 32
HI: 4.5
中樞型呼吸中止: 2
CAI: 0.3
流量限制: 37
流量限制/小時: 5.8
SensAwake 總計: 24
清醒降壓/小時: 3.3



壓力

cmH₂O


中位數: 7.0
百分之 90: 11.
緩慢升壓期
最小/最大



系統漏氣

升/分鐘

中位數: 3
百分之 90: 5
過度漏氣的時間: 5%



處於壓力狀態的時間和事件


壓力 (cmH ₂ O)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
時間 (分鐘)	0	0	0	326	4	6	46	26	12	0	18	0	0	0	0	0	0
OA	0	0	0	4	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
H	0	0	0	14	0	0	9	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0
CA	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FL	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	32	0	0	0	0	0	0

23 一月 2020
 星期四 2:29 下午 - 11:39 下午

姓名: Demo Patient 電話: 0123456789
 病患ID: 1234 電子郵件: Demo.Patient@example.com
 出生日期: 01 一月 1960 性別: 女性


運轉時間

運行總時間: 8:48
 使用百分比: 98




事件

AHI: 7.7
 阻塞型呼吸中止: 25
 OAI: 2.9
 淺呼吸: 35
 HI: 4.1
 中樞型呼吸中止: 6
 CAI: 0.7
 流量限制: 1
 流量限制/小時: 0.1
 SensAwake 總計: 29
 清醒降壓/小時: 3.4




壓力

cmH₂O
 中位數: 7.0
 百分之 90: 12.
 緩慢升壓期
 最小 / 最大



系統漏氣

升/分鐘
 中位數: 4
 百分之 90: 7
 過度漏氣的時間: 29



處於壓力狀態的時間和事件

壓力 (cmH ₂ O)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
時間 (分鐘)	0	0	0	366	8	2	70	28	8	8	38	0	0	0	0	0	0
OA	0	0	0	4	2	2	7	3	4	1	2	0	0	0	0	0	0
H	0	0	0	8	0	0	9	3	3	5	7	0	0	0	0	0	0
CA	0	0	0	2	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
FL	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

30 日分析

姓名： Demo Patient 電話： 0123456789
 病患ID： 1234 電子郵件： Demo.Patient@example.com
 出生日期： 01 一月 1960 性別： 女性

日期	模式	壓力 (cmH ₂ O)	濕度	緩慢升壓	運轉時間 (小時/分鐘)	使用時間 (小時/分鐘)	AHI	CAI	SensAwake 偵測數量	SensAwake壓力 (cmH ₂ O)	吐氣降壓	90%的壓力 (cmH ₂ O)	達到的最大壓力 (cmH ₂ O)	90%的漏氣 (升/分鐘)
25 十二月 2019	Auto	最小 7.0 最大 10.0	7.0	0	7:18	7:18	2.5	0.3	10	7.0	1	7.5	9.0	58
26 十二月 2019	Auto	最小 7.0 最大 10.0	7.0	0	8:12	8:12	1.7	0.1	12	7.0	1	7.0	9.5	55
27 十二月 2019	Auto	最小 7.0 最大 10.0	7.0	0	7:30	7:30	1.4	0.0	11	7.0	1	7.0	8.5	53
28 十二月 2019	Auto	最小 7.0 最大 10.0	7.0	0	9:06	9:06	2.1	0.3	18	7.0	1	7.5	10.0	54
29 十二月 2019	Auto	最小 7.0 最大 10.0	7.0	0	7:30	7:30	3.9	0.3	21	7.0	1	8.0	9.0	57
30 十二月 2019	Auto	最小 7.0 最大 10.0	7.0	0	6:12	6:06	8.4	1.0	22	7.0	1	8.5	10.0	61
31 十二月 2019	Auto	最小 7.0 最大 10.0	7.0	0	10:12	10:00	5.0	0.3	25	7.0	1	8.0	10.0	65
01 一月 2020	Auto	最小 7.0 最大 10.0	7.0	0	9:24	9:24	6.7	0.6	28	7.0	1	9.0	10.0	69
02 一月 2020	Auto	最小 7.0 最大 10.0	7.0	0	8:54	8:54	4.1	0.9	11	7.0	1	8.0	10.0	59
03 一月 2020	Auto	最小 7.0 最大 10.0	7.0	0	9:18	9:18	6.2	1.1	16	7.0	1	8.5	10.0	61
04 一月 2020	Auto	最小 7.0 最大 10.0	7.0	0	9:06	9:06	3.5	0.4	18	7.0	1	8.0	10.0	60
05 一月 2020	Auto	最小 7.0 最大 10.0	7.0	0	8:06	8:06	4.2	0.5	18	7.0	1	8.5	10.0	63
06 一月 2020	Auto	最小 7.0 最大 10.0	7.0	0	9:12	9:12	6.8	0.4	20	7.0	1	9.0	10.0	65
07 一月 2020	Auto	最小 7.0 最大 10.0	7.0	0	4:24	4:18	7.7	0.7	13	7.0	1	9.0	10.0	65
08 一月 2020	Auto	最小 8.0 最大 11.0	7.0	0	8:12	3:42	4.9	0.8	7	7.0	1	9.0	11.0	29
09 一月 2020	Auto	最小 8.0 最大 11.0	7.0	0	9:42	9:42	11.0	1.5	31	7.0	1	10.0	11.0	70
10 一月 2020	Auto	最小 8.0 最大 11.0	7.0	0	10:00	10:00	5.7	0.6	26	7.0	1	9.0	11.0	68
11 一月 2020	Auto	最小 8.0 最大 11.0	7.0	0	9:24	9:18	4.9	0.4	27	7.0	1	8.0	11.0	60
12 一月 2020	Auto	最小 8.0 最大 11.0	7.0	0	10:06	10:06	10.6	2.2	36	7.0	1	9.0	11.0	59
13 一月 2020	Auto	最小 8.0 最大 11.0	7.0	0	9:24	9:24	9.0	1.4	34	7.0	1	9.0	11.0	66
14 一月 2020	Auto	最小 8.0 最大 11.0	7.0	0	9:18	9:12	6.3	0.4	30	7.0	1	8.5	11.0	59
15 一月 2020	Auto	最小 8.0 最大 11.0	7.0	0	8:42	8:36	8.7	0.8	25	7.0	1	8.5	11.0	57
16 一月 2020	Auto	最小 8.0 最大 11.0	7.0	0	9:18	9:18	3.9	0.3	28	7.0	1	8.0	9.5	56
17 一月 2020	Auto	最小 10.0 最大 13.0	7.0	0	8:48	8:48	10.1	1.3	36	7.0	1	11.0	13.0	64
18 一月 2020	Auto	最小 10.0 最大 13.0	7.0	0	8:48	8:42	6.7	0.8	32	7.0	1	10.0	12.0	74
19 一月 2020	Auto	最小 9.0 最大 14.0	7.0	0	7:24	7:24	13.4	1.2	32	7.0	1	14.0	14.0	65
20 一月 2020	Auto	最小 9.0 最大 14.0	7.0	0	8:12	8:12	10.3	0.4	25	7.0	1	10.0	14.0	58
21 一月 2020	Auto	最小 9.0 最大 14.0	7.0	0	9:18	9:18	4.1	0.3	23	7.0	1	7.0	12.0	53
22 一月 2020	Auto	最小 10.0 最大 14.0	7.0	0	7:18	7:12	5.7	0.3	24	7.0	3	11.0	14.0	57
23 一月 2020	Auto	最小 10.0 最大 14.0	7.0	0	8:48	8:36	7.7	0.7	29	7.0	3	12.0	14.0	78