F&P myAirvo 3

Guide de démarrage rapide

À utiliser avec une chambre à remplissage automatique



plier ici

Consulter les instructions d'utilisation complètes du F&P myAirvo 3.

F&P et myAirvo sont des marques commerciales de Fisher & Paykel Healthcare Limited.
REF 629090 REV B 2026-03 © 2026 Fisher & Paykel Healthcare Limited


Fisher & Paykel HEALTHCARE

www.fphcare.com

Fisher & Paykel HEALTHCARE

F&P myAirvo 3

Installation

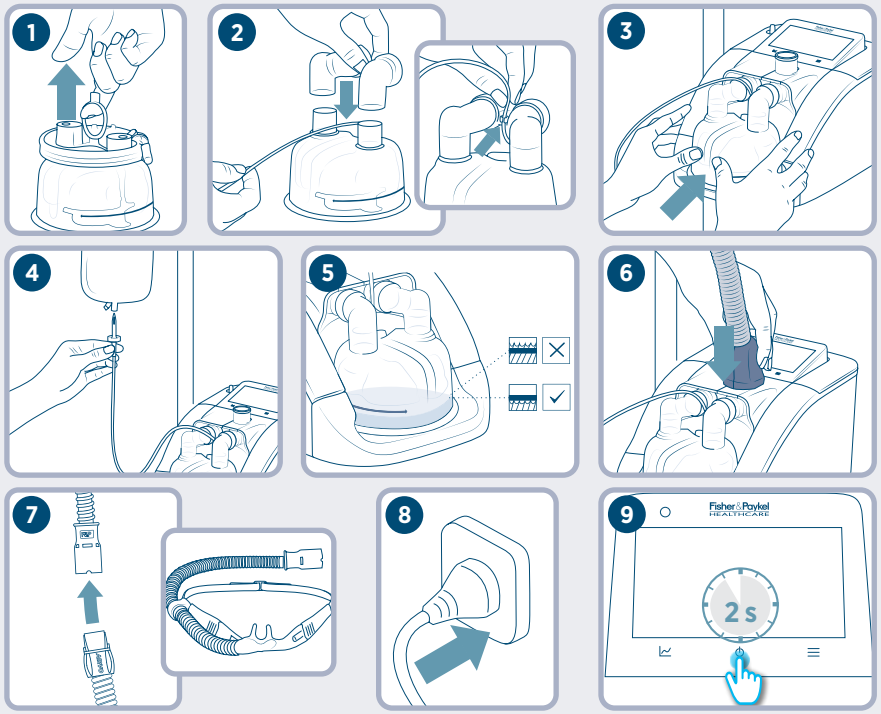


Démarrage du traitement




Consulter les instructions d'utilisation complètes du F&P myAirvo 3.

plier ici


2 Interface nasale

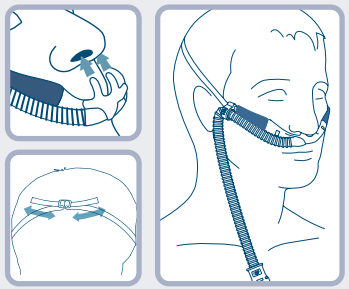


Interface de trachéotomie

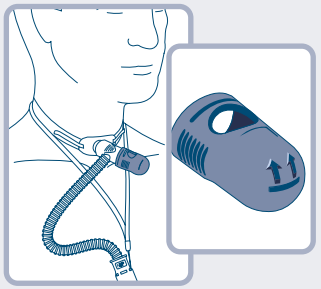

Optionnel :
Utilisation d'un oxymètre de pouls

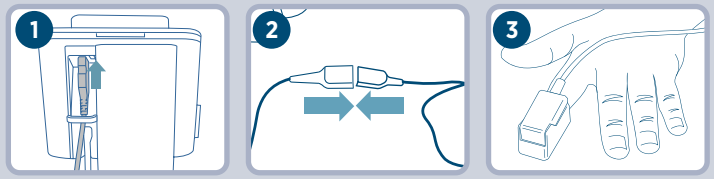


Apport d'oxygène

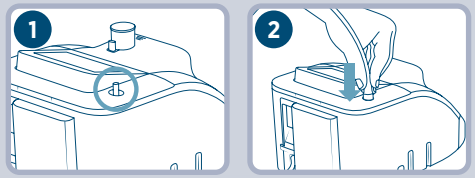


Terminer le traitement



Nettoyage quotidien

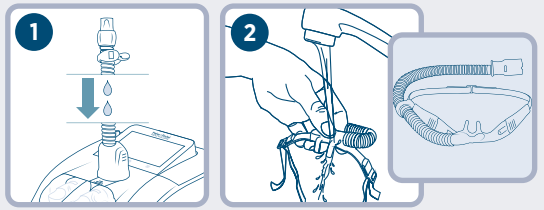

Nettoyage hebdomadaire

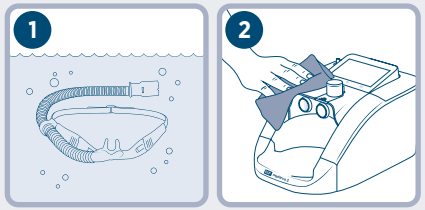

Fisher & Paykel HEALTHCARE