

## ANPASSUNGSANWEISUNG



PRODUKT	OJR410	OJR412	OJR414	OJR416	OJR418	OJR520
GRÖSSE DER NASENKANÜLE	XS	S	M	L	XL	XXL
F&P WigglewiNG™						

WJR210

WJR212

WJR214

## Nachfolgend ist ein empfohlenes Verfahren zum Anlegen des F&P WigglewiNG beschrieben:

Beachten Sie zur korrekten Positionierung des F&P WigglewiNG die Anweisungen zur Platzierung des F&P Wigglepads™ 2 in der Gebrauchsanleitung der F&P Optiflow™ Junior 2 und F&P Optiflow Junior 2+ Nasenkanüle.

### IN ZWEI STÜCKE REISSEN

#### 1 Haut präparieren

Haut gemäß den Klinikrichtlinien vorbereiten.

Nasenloch wählen, in das die nasogastrale Sonde eingeführt werden soll. Den F&P WigglewiNG über der Wange des Patienten auf derselben Seite wie dieses Nasenloch halten.

Richten Sie die weißen Tabs (mit ② gekennzeichnet) zu sich selbst hin und die Klettfläche von Ihnen weg. Platzieren Sie den geraderen Rand zur Nase des Patienten hin.

② Das gesamte obere Drittel des F&P WigglewiNG (distal zum Kinn des Patienten) **ABREISSEN**, indem Sie es in der Mitte festhalten und den oberen Teil abreißen. Damit verbleiben Ihnen die unteren 2/3 des F&P WigglewiNG.



### AUF DAS GESICHT KLEBEN

#### 3 Blaus Tab

Das blaue Tab (mit ① gekennzeichnet) abziehen.


Den F&P WigglewiNG auf die Wange des Patienten **KLEBEN**.

#### 4 Weißes Tab

Die weißen Tabs (mit ② und F&P WigglewiNG gekennzeichnet) abziehen.

Die NG-Sonde gemäß Klinikrichtlinien einführen.

Die NG-Sonde entlang der Perforationen platzieren.

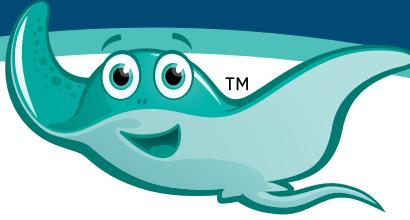

## ANPASSUNGSANWEISUNG

### UMFALTEN, UM DIE NG-SONDE ZU FIXIEREN

#### 5 Umfalten

Den F&P WigglewiNG umfalten, um die NG-Sonde zu fixieren.

Wenden Sie den in Schritt 2 entfernten Abschnitt wie ein Wigglepad auf der gegenüberliegenden Wange an. Entfernen Sie das vorhandene Wigglepad von der Nasenkanüle.

#### 6 Kanüle fixieren

Die Kanüle so fixieren, dass die Kanülenbrücke direkt unter der Nase liegt, das Septum dabei jedoch nicht berührt wird. Die Kanüle während des Anlegens nicht auseinanderziehen.

**5****6**

### ENTFERNUNG DES F&P WIGGLEWING

#### 1 Fingerspitze auflegen


Die Fingerspitze auf den äußeren Rand des F&P WigglewiNG auflegen und die Nasenkanüle vorsichtig abziehen. Vom äußeren Rand in Richtung Nase abziehen.

#### 2 Rand hochziehen

Den Rand des F&P WigglewiNG hochziehen. Mit einem angefeuchteten Tuch die Haut des Patienten und die Unterseite des F&P WigglewiNG abtupfen und die Pads dabei vorsichtig vom Gesicht des Patienten abziehen.

#### 3 Ablösen

Die NG-Sonde zwischen der Nase des Patienten und dem F&P WigglewiNG gut festhalten und die NG-Sonde vom F&P WigglewiNG ablösen, indem Sie sie entlang der Perforationen abziehen.

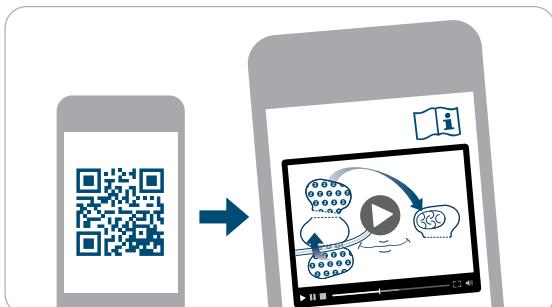**2****3**

WICHTIG: Stets die Gebrauchsanleitung beachten, die mit dem Produkt geliefert wird. Dort finden Sie die vollständigen Benutzerhinweise zum Setup, Warnhinweise, Kontraindikationen und Erläuterungen.

[www.fphcare.com](http://www.fphcare.com)